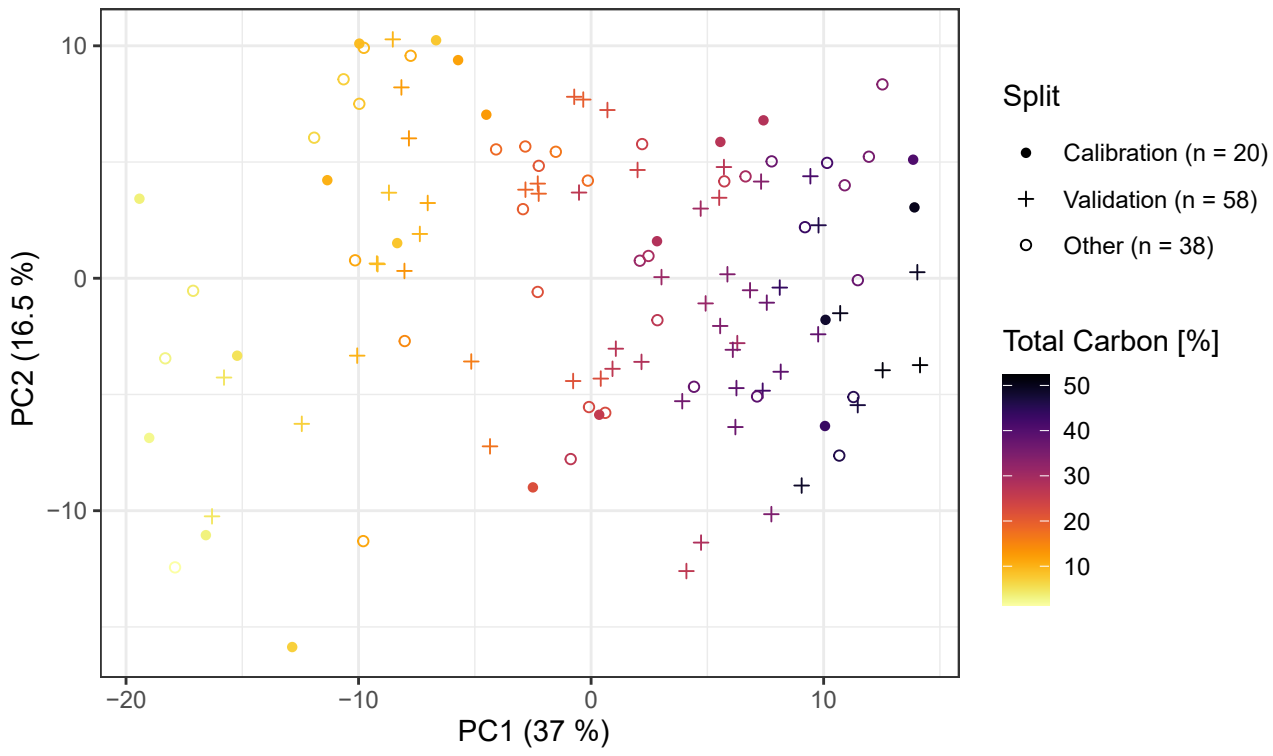
Split
Calibration (n = 20)
Validation (n = 58)
Other (n = 38)
Total Carbon [%]
50
40
30
20
10
PC2 (16.5 %)
PC1 (37 %)
10
0
−10
−20
−10
0
10